




HEMOSTASIA



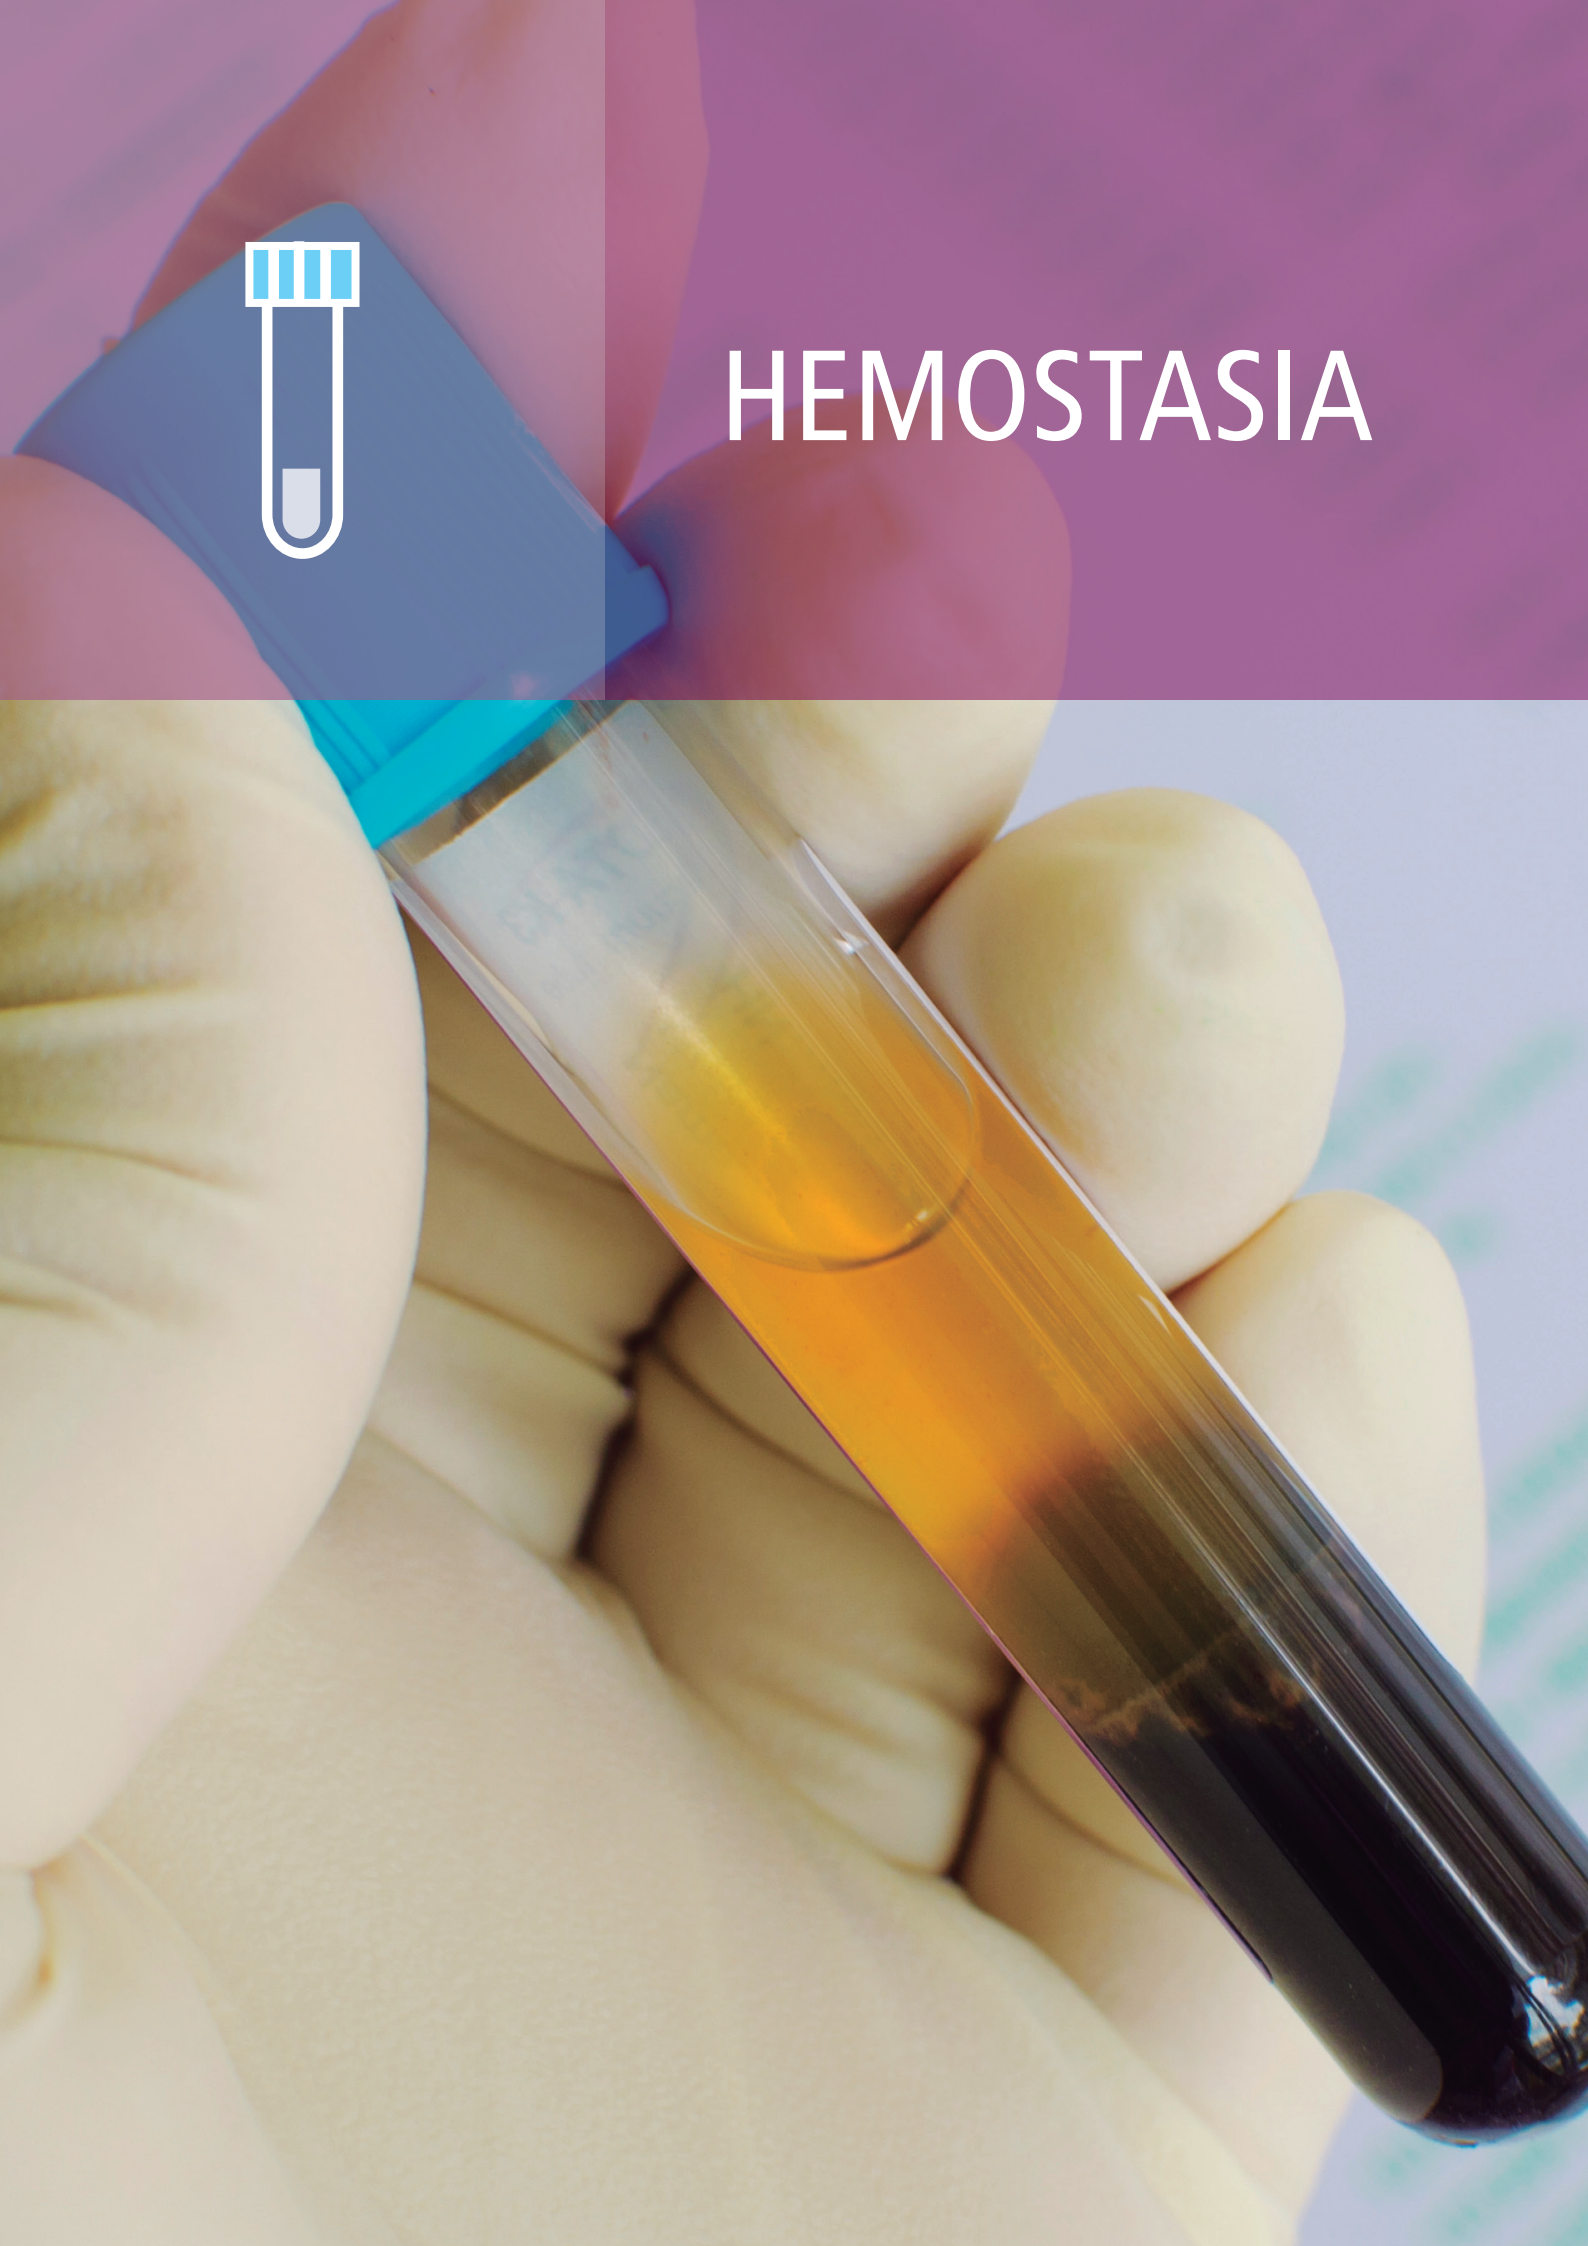

HEMOSTASIA

PRUEBAS GLOBALES

Analito	Producto	Código	Método	Presentación
Fibrinógeno	Fibrinógeno	1705006	Coagulométrico	10 x 1 mL
Tiempo de Protrombina	Prothrombin Time Plus	1705027		10 x 4 mL (*)
	Soluplastín	1705005		10 x 4 mL (*)
		1705001		10 x 2 mL
		1705003		8 x 8 mL
Tiempo de Trombina	Tiempo de Trombina	1705009		6 x 2 o 3 mL
Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado	APTTTest	1705002		6 x 2,5 mL A + 1 x 15 mL B
	APTTTest elágico	1705004		6 x 2,5 mL A + 1 x 15 mL B

(*) Presentación con asignación de ISI para método manual, sistemas CoL y CoR 50.

PRUEBAS ESPECIALES

Analito	Producto	Código	Método	Presentación
Antitrombina III	Chrom ATIII	1705012	Cromogénico	1 x 20 mL A + 1 x 8 mL B + 2 x 25 mL C
APTT Sensible a anticuerpos antifosfolípidos	APTT ellagic	1705010	Coagulométrico	2 x 4 mL A + 1 x 8 mL B
Confirmatorio de Anticoagulante Lúpico	LA Confirm	1705024		5 x 1 mL
Dímero D	D-Dimer Turbites AA	1705031	Turbidimétrico	4 mL A + 4 mL B + 4 mL C + 1 mL cal
Factor II	Factor II Deficient Plasma	1705014	Coagulométrico	5 x 1 mL
Factor V	Factor V Deficient Plasma	1705015		5 x 1 mL
Factor VII	Factor VII Deficient Plasma	1705016		5 x 1 mL
Factor VIII	Factor VIII Deficient Plasma	1705017		5 x 1 mL
Factor IX	Factor IX Deficient Plasma	1705018		5 x 1 mL
Factor X	Factor X Deficient Plasma	1705019		5 x 1 mL
Factor XI	Factor XI Deficient Plasma	1705020		5 x 1 mL
Factor XII	Factor XII Deficient Plasma	1705021		5 x 1 mL
Proteína C	Chrom Protein C	1705013	Cromogénico	3 x 1 mL A + 3 x 1 mL B + 1 x 60 mL C + 3 x 1 mL calibrador
Screening de Anticoagulante Lúpico	LA Screen	1705023	Coagulométrico	5 x 2 mL

CONTROLES Y CALIBRADORES

Analito	Producto	Código	Uso	Presentación
Control Dímero D	D-Dimer Control Turbites AA	1705034	Para el control normal y patológico de dímero D	Control 1 - 2 x 1 mL + control 2 - 2 x 1 mL
Control Normal	Plasma Control Normal	1937001	Plasma normal y patológico para el control de las determinaciones de TP, TT, APTT y Fibrinógeno.	6 x 1 mL
Control Normal especialidad	Coagulation Control N	1937004	Plasma normal y patológico para el control de las determinaciones de TP, TT, APTT, Fibrinógeno, ATIII, PC, Factores vía intrínseca y extrínseca.	2 x 1 mL